

連携施設様

誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

大阪掖済会病院

厚生労働省通知を受け、誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。

特に経腸栄養分野においては、円滑な施設間連携を図るため、本紙を持って情報提供させていただきます。

当院の製品切り替え予定

2021年4月1日（木）より順次新製品へ切り替えます。

今後の対応

切り替え以降に当院から転出される患者さんは
右図の新規格タイプ

「オスコネクタ」を使用します。

このタイプの製品を接続するためには

- ①「新規格メスコネクタ」の製品を直接接続する。
- ②「変換コネクタ」を介して


既存規格のオスの製品と接続する。

のどちらかで対応する必要があります。

特に旧規格と新規格で異なる接続を行う場合は

「変換コネクタ」がないと接続できません。

**今回の規格変更について、施設間での
混乱がないよう、お手数をおかけしますが、
ご協力のほどお願い致します。**

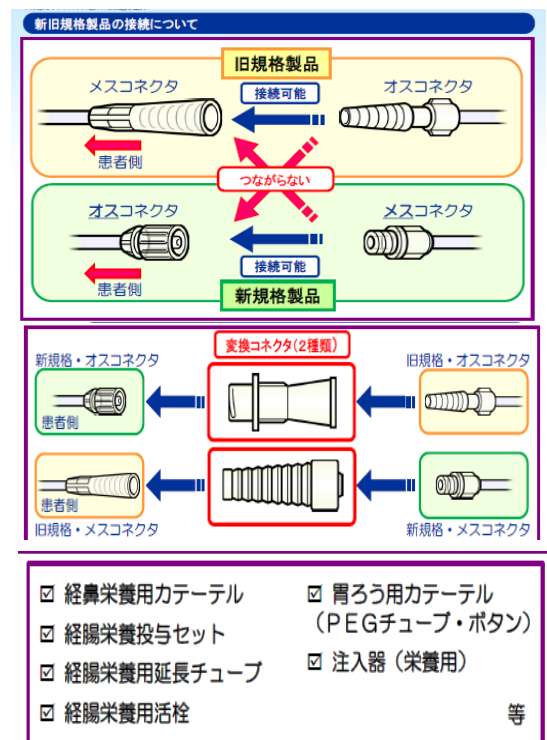

連携施設様へのお願い

2021年4月1日（木曜日）以降については、貴施設におかれましても

「変換コネクタ」のご準備もしくは新製品の切り替えをお願い致します。

問い合わせ・連絡先

公益社団法人 日本海員掖済会 大阪掖済会病院 入退院管理室（看護部 医療安全担当）

TEL 06-6581-2881

（ 問い合わせ時間：平日 9：00～17：00 ）